A.MENARINI diagnostics

GUIDE DES SOLUTIONS PROFESSIONNELS DE SANTÉ

ACCOMPAGNER AUJOURD'HUI LES LABORATOIRES DE DEMAIN

Ces produits sont destinés à des professionnels de santé et sont conformes à la (aux) destination (s) au sens de la directive 98/79/CE ou de la réglementation (EU) 2017/746. Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage et/ou la notice d'utilisation.



AMDPM0019-0226-V1

VOS CONTACTS

Hot-line SAV

Lundi - Vendredi : 8h30 -17h30
Samedi : 9h-17h

- **Hotliner technicienne SAV : Mme Cindy QUIDET** hotlinediag@menarini.fr - 01 56 34 69 30

Et 6 techniciens terrains à votre service dans toute la France métropolitaine.

Commercial

- **Directeur Commercial : Mr Thomas GUILHAUMON** tguilhaumon@menarini.fr - 06 80 93 75 26
- **Secteur Nord-Ouest : Mr Vidian DE CONCINI** vdeconcini@menarini.fr - 06 80 93 75 10
- **Secteur Nord-Est et Île-de-France : Mr Gaëtan AVOT** gavot@menarini.fr - 06 50 03 20 13
- **Secteur Sud-Est : Mr Bastien ISOARD** bisoard@menarini.fr - 06 74 95 28 34
- **Secteur Sud-Ouest : Mr Claude NGUYEN** cnguyen@menarini.fr - 06 60 73 77 47
- **Cheffe de Produit : Mme Clémence MARIE** cmarie@menarini.fr - 06 33 06 66 63

Applicatif

- **Responsable d'équipe Application : Mr Christophe VALLET**
  service-applicatif@menarini.fr - cvallet@menarini.fr - 06 85 03 68 79
- **Ingénieur d'application : Mr Florian GUERARD** fguerard@menarini.fr - 06 80 93 73 75
- **Ingénieur d'application : Mr Jullien BALLEY** jballey@menarini.fr - 06 07 48 02 95
- **Ingénieur d'application : Mr Enrico ZULIANI** ezuliani@menarini.fr - 06 71 92 20 89

Administration des Ventes

Lundi - Jeudi : 9h -17h45
Vendredi : 9h-16h30

- **Responsable ADV : Mme Aulfa BEN LAGHA** service-commande@menarini.fr - 01 56 34 69 23

Qualité

- **Responsable Assurance Qualité/ Affaires Réglementaires : Mme Christelle COURIVAUD DUVAL**
  service_qualite@menarini.fr - 06 70 48 21 95

HÉMATOLOGIE - EDTA

A.Menarini Diagnostics est le distributeur exclusif des automates d'hématologie MINDRAY.
Cette gamme propose des solutions adaptées à toute taille de laboratoire.

BC-7600 Series

Analyseurs d'hématologie automatiques






Nouveau

H-120

Analyseur d'hémoglobine glyquée







SC-120 — *Etaleur colorateur*

MC-80 — *Analyseur de morphologie cellulaire*

AUTOMATES DE PAILLASSE



BC-780R et BC-760CS

Analyse microscopique automatisée

Nouveau



SC-10 — *Etaleur*




BSJ-DB228 — *Colorateur*



MC-30 — *Analyseur de morphologie cellulaire*

LabXpert

Logiciel de validation automatique et manuelle pré-programmée selon les recommandations du GFHC

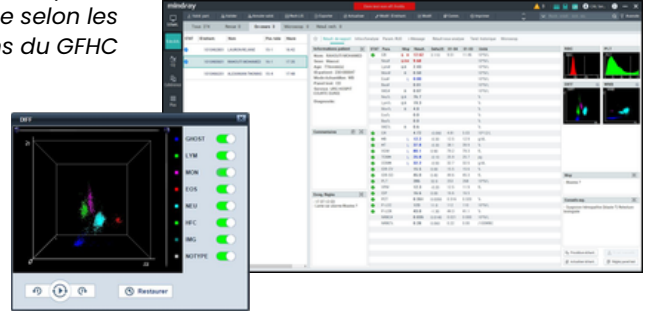

CAL 7000 : Ligne d'analyse cellulaire modulable

MC-80 · SC-120 · H-120 · BC-7600 Series



CAL 7000 (1111)

MC-80 · SC-120 · H-120 · 2x BC-7600 Series




CAL 7000 (2111)

All in CD+ESR+HbA1c+>>> SF Cube

Nouveau

CAL 9000 : Ligne d'analyse cellulaire

LabXpert · H-120 · MC-80 · SC-120 · BC-7600 Series

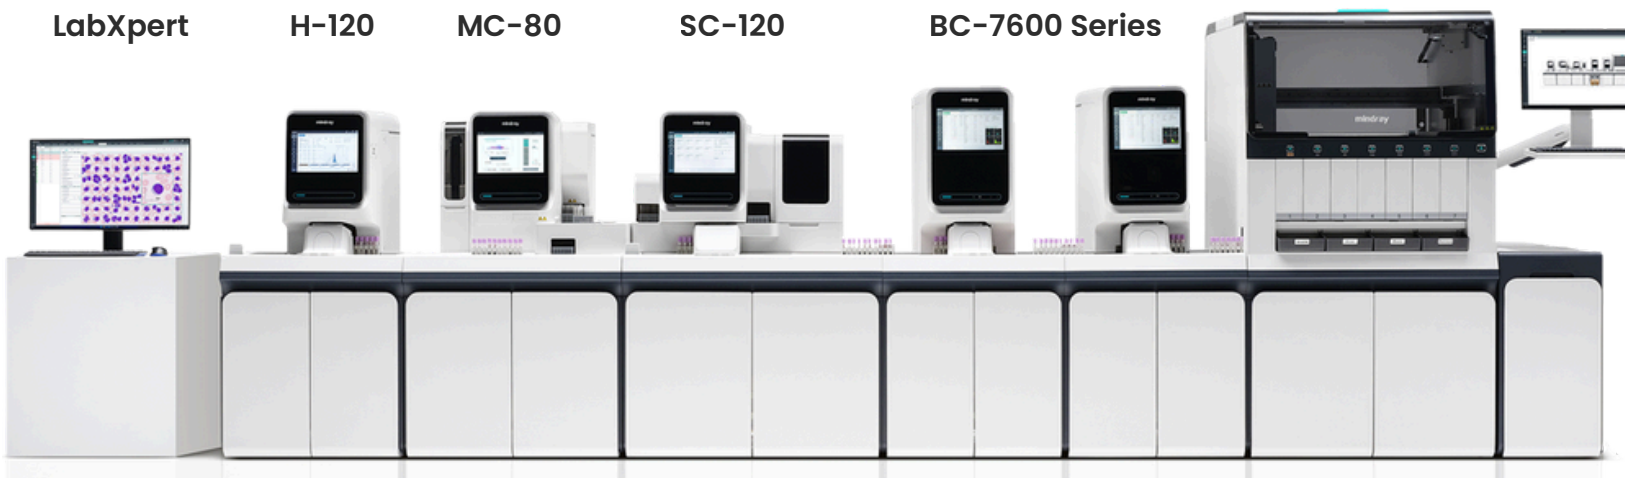

TM-1000 *Module pré et post-analytique*

BULK
Module de chargement des échantillons

CR-30[H]
Système de distribution de réactifs concentrés

En savoir plus

DIAGNOSTIC MOLÉCULAIRE

Cet automate d'analyse par **qPCR**, allie une vitesse d'analyse comprise **entre 20 et 35 minutes**, avec un **menu de tests en constante expansion**.



COYOTE®

FlashDetect™ Flash10

Jusqu'à 4 tests simultanés



Catalogue de tests

- Infections Respiratoires
- Infections Gastrointestinales
- Infections Nosocomiales
- Infections Sexuellement Transmissibles
- Infections à Diffusion Sanguine
- Maladies Infectieuses tropicales
- Tests génétiques
- Tests vétérinaires

En savoir plus


SÉDIMENTATION URINAIRE

SediMAX™ conTRUST PRO


Analyseur microscopique automatisé



- **Pas de réactif** nécessaire
- Cadence de **150 échantillons/heure**
- Maintenance quotidienne automatique
- **Double microscope intégré**

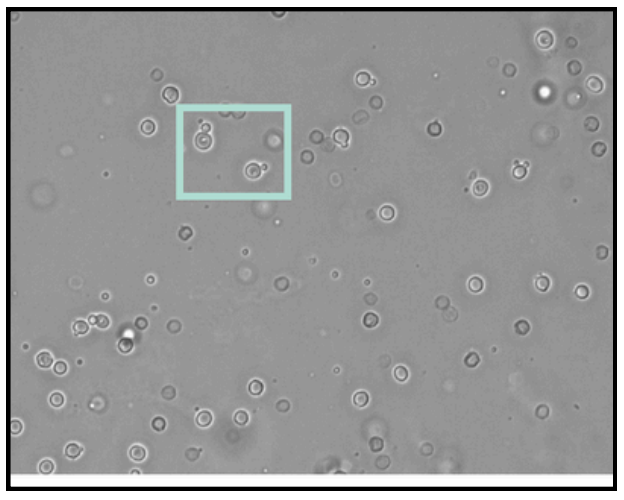

Lumière directe

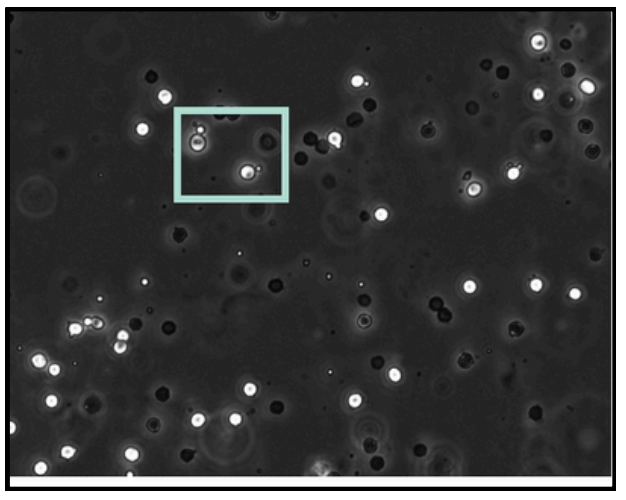

Contraste de phase

En savoir plus

POUR PLUS D'INFORMATIONS



01 45 60 77 20

1 rue du Jura
94633 Rungis Cedex

A.MENARINI diagnostics France

www.menarinidiagnostics.fr

Scannez pour accéder

AMDPM0082-0926-V2

Ces produits sont destinés à des professionnels de santé et sont conformes à la (aux) destination (s) au sens de la directive 98/79/CE ou de la réglementation (EU) 2017/746. Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage et/ou la notice d'utilisation.